


Hinweise für den Notfall! Achtung!


Name: Tel. Kontaktperson.....



Ich bin Träger eines Neurostimulators.

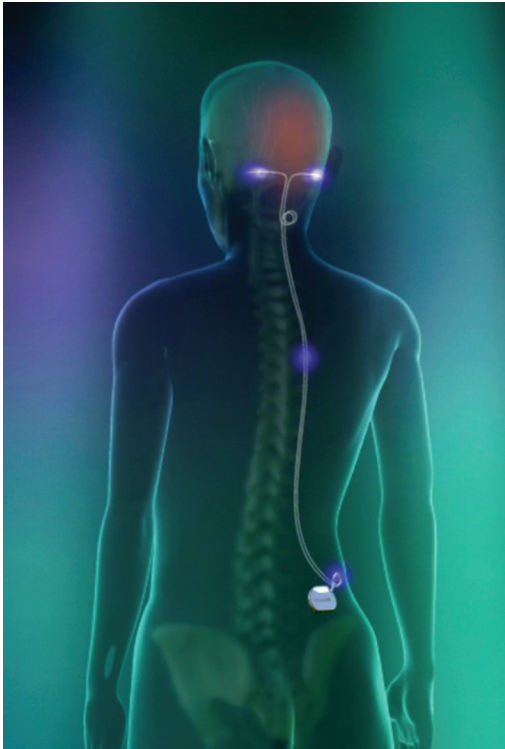

Er ist rechts unten im Rückenbereich implantiert. Es befinden sich zudem 2 Elektroden im Hinterkopf an den Occipitalis-Nerven, die mit Kabeln den Rücken entlang mit dem Neurostimulator verbunden sind. Zum Bedienen (Ein-Aus-Schalten, Stimulation ändern...) befindet sich eine Fernbedienung in meiner Handtasche!

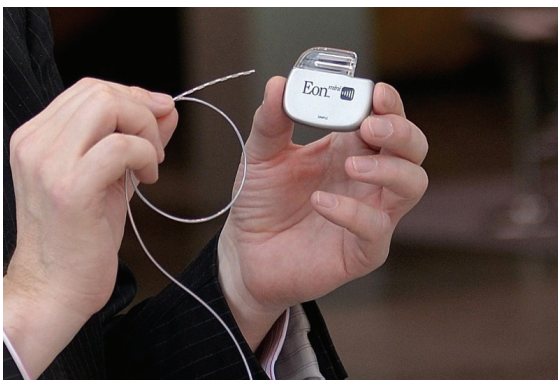

Neurostimulator und Elektrode



Fernbedienung

Es dürfen keine MRT- oder Diathermie-Untersuchungen durchgeführt werden, da der Neurostimulator magnetisch ist!

Röntgen und CT sind erlaubt. Es kann jedoch Artefakte geben, die die Auswertung erschweren oder Organe überdecken. Beim Röntgen ggf. Neurostimulator abschirmen, um Streustrahlung zu vermeiden!

Ultraschall nicht direkt über dem Neurostimulator! Bitte nur vom Bauch aus schallen.

Telefonnummer meines betreuenden Arztes:

Schmerzlinik Kiel, Prof. Dr. Hartmut Göbel, Tel.: 0049 431 20099400